


デュートロン製品の高性能を支える

校正 & 調整校正




機器を最良の状態を使うのに、校正 & 調整校正は欠かせません
東洋テックはデュートロン製品の、校正のみならず 調整校正も可能です

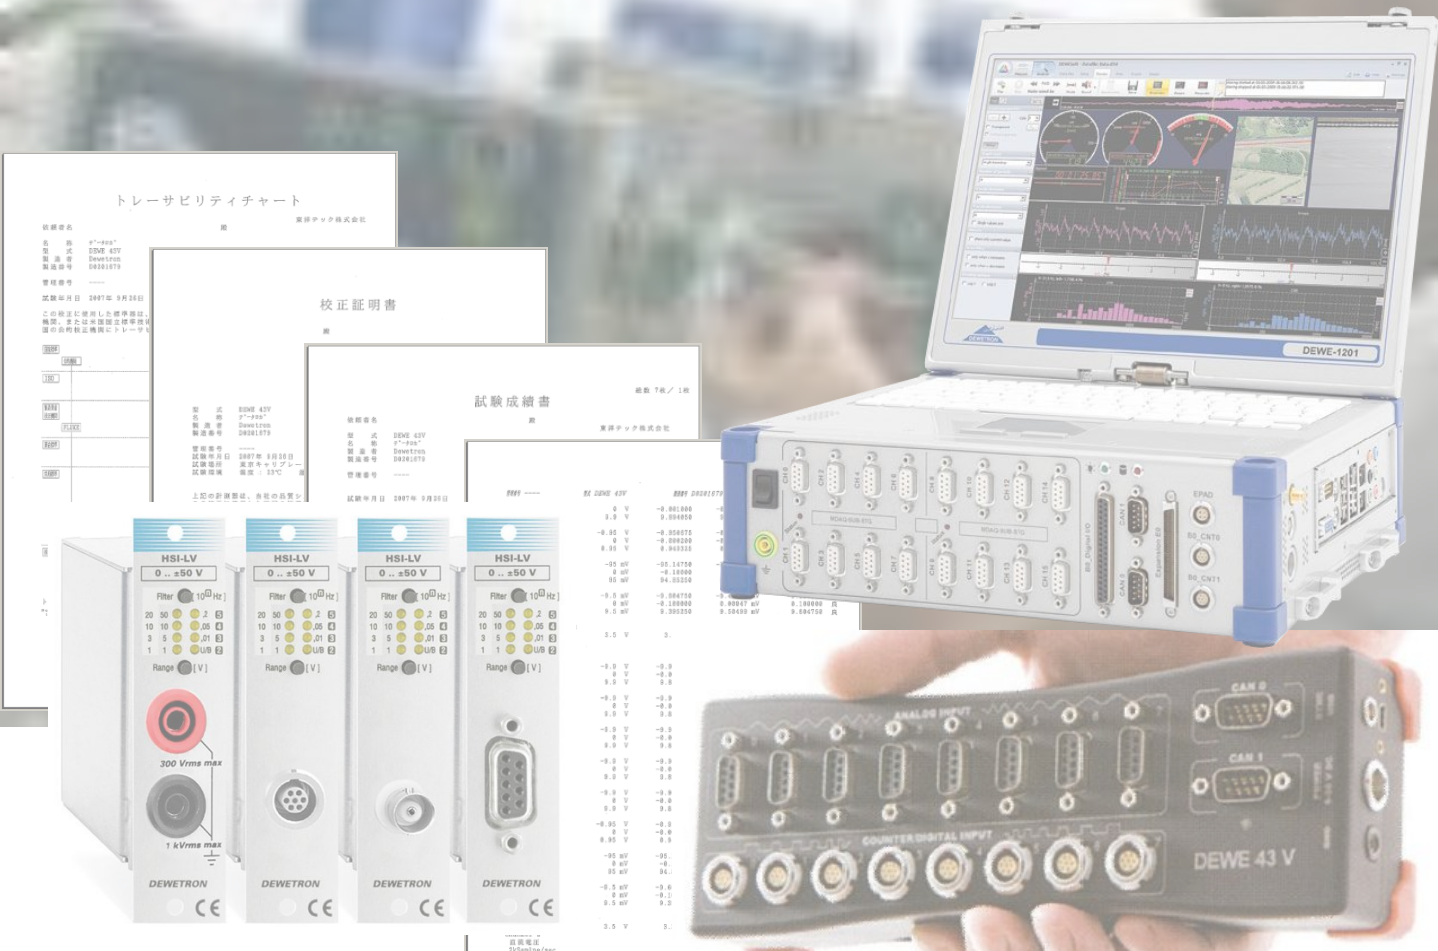

■ 調整校正の必要性

入力部のアンプは、経年変化により±バランスがくずれ、出力部にオフセット電圧が生じ、波形を歪ませることがあります。調整校正がこの不具合を防ぎます。

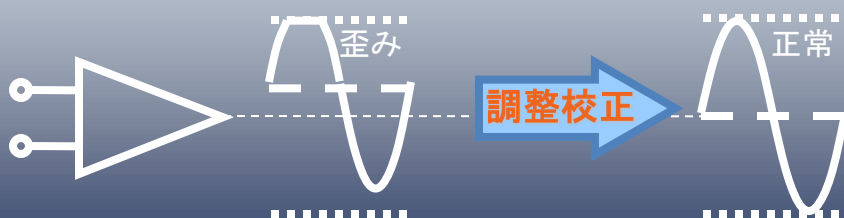

東洋テックはデュートロン製品の調整校正も可能です

■ 校正価格 (校正証明書、試験成績書、トレーサビリティチャート付き 2012年10月現在)

型式	内容	後データ付き、校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き、調整校正 (型式-RECAL-TO)	型式	内容	後データ付き、校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き、調整校正 (型式-RECAL-TO)				
DAQモジュール				MDAQモジュール							
低電圧モジュール(Optで電流) DAQP-LV-CAL-TO 校正 DAQP-LV-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500	MDAQシリーズ電圧モジュール16ch MDAQ-V10-CAL-TO 校正 MDAQ-V10-RECAL-TO 調整校正 MDAQ-V100-CAL-TO 校正 MDAQ-V100-RECAL-TO 調整校正	16チャンネル 各レンジ各チャンネル3点校正 ADカードの校正も含む	¥40,000	¥64,500				
低電圧モジュール DAQ-V-CAL-TO 標準校正 DAQ-V-RECAL-TO 最適校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥20,500	¥35,200	MDAQシリーズ電圧モジュール8ch MDAQ-SUB-V-CAL-TO 校正 MDAQ-SUB-V-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル 各レンジ各チャンネル3点校正 MDAQ-BASEを含む各レンジ 各チャンネル3点校正 ADカードの校正も含む	¥49,000	¥78,000				
電圧モジュール(Optで電流) DAQP-V-A-CAL-TO 校正 DAQP-V-A-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500	MDAQシリーズIPE-電圧モジュール8ch MDAQ-SUB-ACC-CAL-TO 校正 MDAQ-SUB-ACC-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル MDAQ-BASEを 含む各レンジ各チャンネル3点 校正 ADカードの校正も含む	¥37,500	¥60,700				
電圧モジュール(Optで電流) DAQP-V-B-CAL-TO 校正 DAQP-V-B-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥20,500	¥35,200	MDAQシリーズひずみモジュール8ch MDAQ-SUB-BRIDGE-CAL-TO 校正 MDAQ-SUB-BRIDGE-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル MDAQ-BASEを 含む各レンジ各チャンネル3点 校正 ADカードの校正も含む	¥47,000	¥75,000				
高電圧モジュール DAQP-DMM-CAL-TO 校正 DAQP-DMM-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥20,500	¥35,200	MDAQシリーズひずみモジュール8ch MDAQ-SUB-STG-CAL-TO 校正 MDAQ-SUB-STG-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル MDAQ-BASEを 含む各レンジ各チャンネル3点 校正 ADカードの校正も含む	¥47,000	¥75,000				
高電圧モジュール DAQP-HV-CAL-TO 校正 DAQP-HV-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
歪みゲージモジュール DAQP-BRIDGE-CAL-TO 校正 DAQP-BRIDGE-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
ユニバーサル入力モジュール DAQP-STG-CAL-TO 校正 DAQP-STG-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
マルチファンクションモジュール DAQP-MULTI-CAL-TO 校正 DAQP-MULTI-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
電流モジュール DAQP-LA-CAL-TO 校正 DAQP-LA-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
ACブリッジモジュール DAQP-CFB-CAL-TO 校正 DAQP-CFB-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥24,000	¥40,500								
ACキャリア インタクティブアンプモジュール DAQP-TRQ-CAL-TO 校正 DAQP-TRQ-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 機能チェックのみ (注:ゲインが自在可変のため)	¥16,000	¥28,500								
IEPEモジュール DAQP-ACC-A-CAL-TO 校正 DAQP-ACC-A-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジをAC信 号にて校正 ADカードの校正は含まず	¥20,500	¥35,200								
ダイナミックチャージモジュール DAQP-CHARGE-CAL-TO 校正 DAQP-CHARGE-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジをAC信 号にて校正 ADカードの校正は含まず	¥25,000	¥42,000								
周波数電圧モジュール DAQP-FREQ-A-CAL-TO 校正 DAQP-FREQ-A-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥20,500	¥35,200								
熱電対モジュール DAQP-THERM-CAL-TO 校正 DAQP-THERM-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ3点校正 ADカードの校正は含まず	¥16,000	¥28,500								
熱電対用入力モジュール DAQN-THERM-CAL-TO 校正 DAQN-THERM-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 5点校正 ADカードの校正は含まず	¥16,000	¥28,500								
測温抵抗体モジュール DAQN-RTD-CAL-TO 校正 DAQN-RTD-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル 各レンジ5点校正 ADカードの校正は含まず	¥16,000	¥28,500								
PADモジュールとEPADモジュール				MSIモジュール							
電圧モジュール8ch(Optで電流) PAD-V8-P-CAL-TO 校正 PAD-V8-P-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル チャンネル当たり4点校正	¥22,000	¥37,500	マルチコネクタ MSI-BR-THG-CAL-TO 校正 MSI-BR-THG-RECAL-TO 調整校正	Detailed DEWETRON calibration report for a MSI-BR-TH-x	¥7,500	¥15,700				
熱電対・測温抵抗体モジュール8ch PAD-T8-P-CAL-TO 校正 PAD-T8-P-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル チャンネル当たり3点校正	¥22,000	¥37,500	マルチコネクタ MSI-BR-ACC-CAL-TO 校正 MSI-BR-ACC-RECAL-TO 調整校正	Detailed DEWETRON calibration report for a MSI-x-ACC	¥7,500	¥15,700				
熱電対用入力モジュール8ch PAD-CB8-P2-CAL-TO 校正 PAD-CB8-P2-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル チャンネル当たり3点校正	¥24,000	¥40,500	マルチコネクタ MSI-BR-V200-CAL-TO 校正 MSI-BR-V200-RECAL-TO 調整校正	Detailed DEWETRON calibration report for a MSI-BR-V200	¥7,500	¥15,700				
測温抵抗体用入力モジュール8ch PAD-CB8-RTD2-CAL-TO 校正 PAD-CB8-RTD2-RECAL-TO 調整校正	1チャンネル チャンネル当たり4点校正	¥24,000	¥40,500	マルチコネクタ MSI-BR-RTD-CAL-TO 校正 MSI-BR-RTD-RECAL-TO 調整校正	Detailed DEWETRON calibration report for a MSI-x-RTD	¥7,500	¥15,700				
EPAD2シリーズ電圧モジュール8ch EPAD2-V8-P-CAL-TO 校正 EPAD2-V8-P-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル チャンネル当たり4点校正	¥22,000	¥37,500	マルチコネクタ MSI-BR-CH-CAL-TO 校正 MSI-BR-CH-RECAL-TO 調整校正	Detailed DEWETRON calibration report for a MSI-x-CH-x	¥7,500	¥15,700				
EPAD2シリーズ熱電対モジュール8ch EPAD2-T8-P-CAL-TO 校正 EPAD2-T8-P-RECAL-TO 調整校正	8チャンネル チャンネル当たり3点校正	¥40,000	¥64,500								
熱電対用入力モジュール7ch PAD-A01-CAL-TO 校正 PAD-A01-RECAL-TO 調整校正	7チャンネル チャンネル当たり3点校正	¥17,500	¥30,700								
データロガー								データロガー			
								DEWE-40-CAL-TO 校正 DEWE-40-RECAL-TO 調整校正			
								DEWE-43-CAL-TO 校正 SIRIUS-RECAL-TO 調整校正			
								DEWE-101-CAL-TO 校正 DEWE-101-RECAL-TO 調整校正			

東洋テック株式会社 <http://www.toyotech.co.jp>

■ 本社、東京キャリブレーションセンター
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル
Tel: 03-3251-8676(代) Fax: 03-3251-8258

■ **認定校正** 東洋テック キャリブレーション・ラボラトリーは、ISO/IEC17025 に基づく校正機関として認定されています
ISO/IEC 17025 認定校正

- ・ 電磁気量: 直流電圧, 直流電流, 交流電圧, 交流電流, 直流抵抗
- ・ 幾何学量: マイクロメータ
- ・ 熱力学量: 抵抗温度計, 熱電対温度計, 温度校正装置



お問合せ先 **お買い上げ販売会社**

東洋テック株式会社 計測器の校正受託